


診査基準画面の解決策

事象


右のスクロールバーを下にしても、後ろの保険設計画面がスクロールし、診査基準画面がスクロールしない。

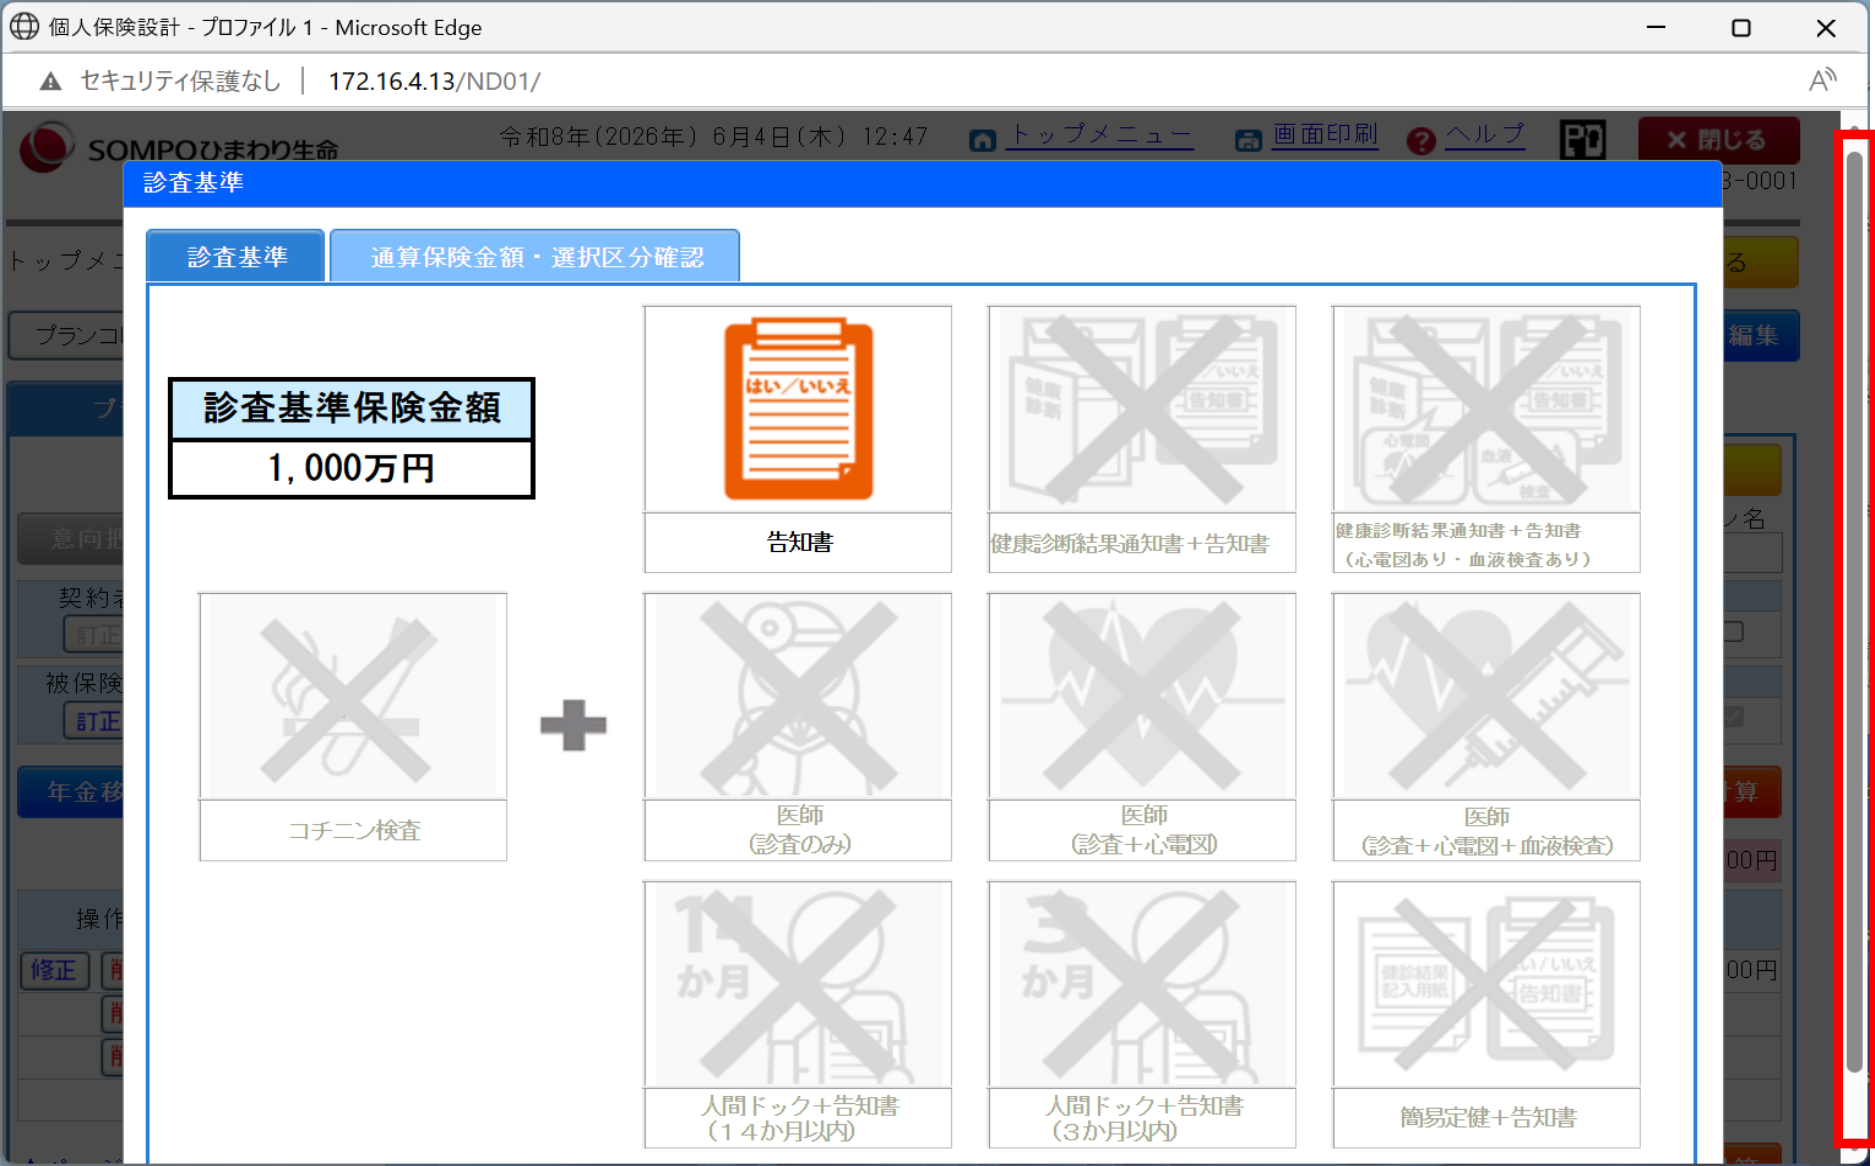

そのため、「閉じる」ボタンが表示されない。



ディスプレイのアイコンがないところを、右クリック→「ディスプレイ設定」を押下する。

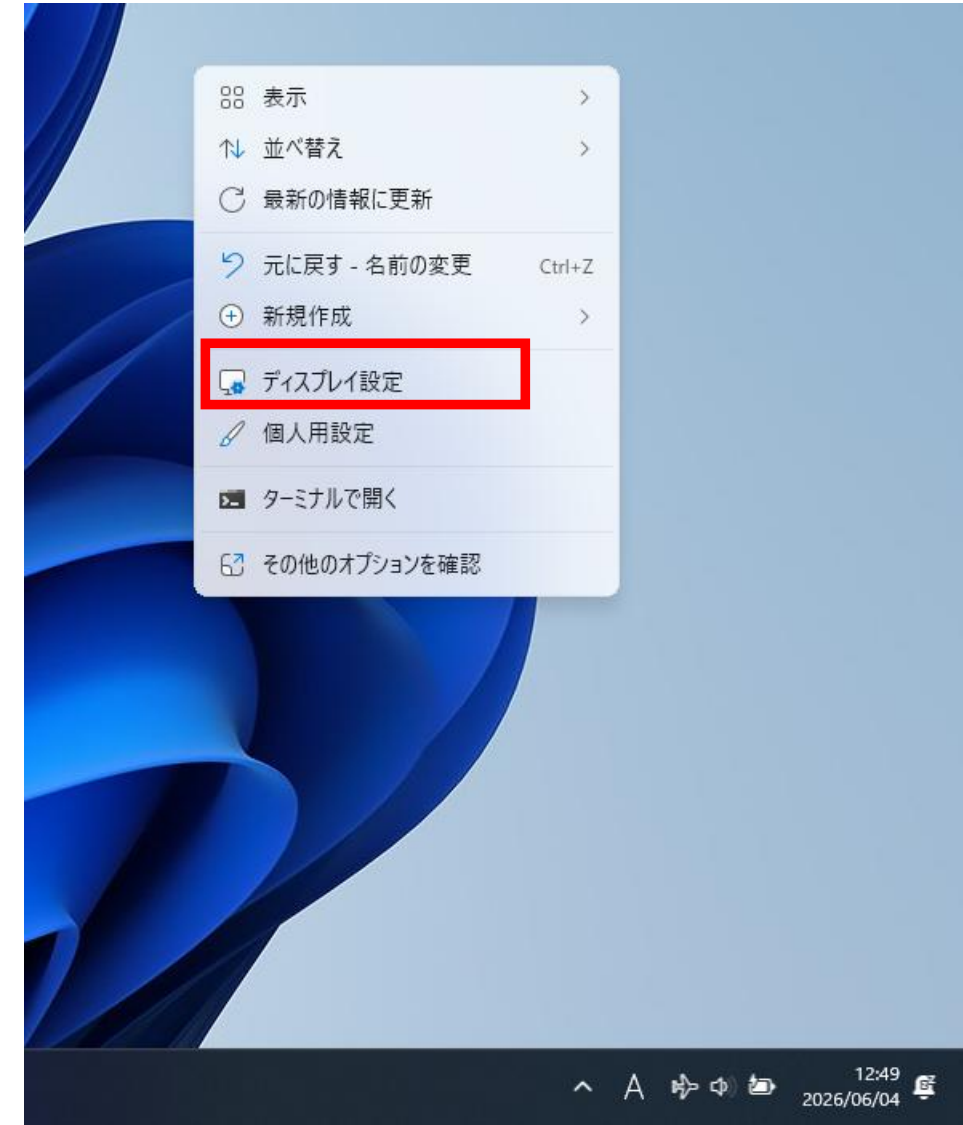

拡大縮小とレイアウトが150%になっている場合、発生する。

システム

>

ディスプレイ

明るさと色

明るさ

内蔵ディスプレイの明るさを変更する

夜間モード

青色の光をブロックするために、暖色を使用する

オフ

>

カラー プロファイル

画面に表示される色を決定する

>

HDR

HDR に関する詳細情報

>

拡大縮小とレイアウト

拡大/縮小

テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更します

一部のアプリは、閉じてもう一度開くまで、拡大縮小の変更に応答しません。

150% (推奨)

>


ディスプレイの解像度

接続されているディスプレイに合うように解像度を調整する


1920 × 1080 (推奨)

>

右のスクロールバーを下にすると、前の診査基準画面がスクロールするので、「閉じる」ボタンが表示される。

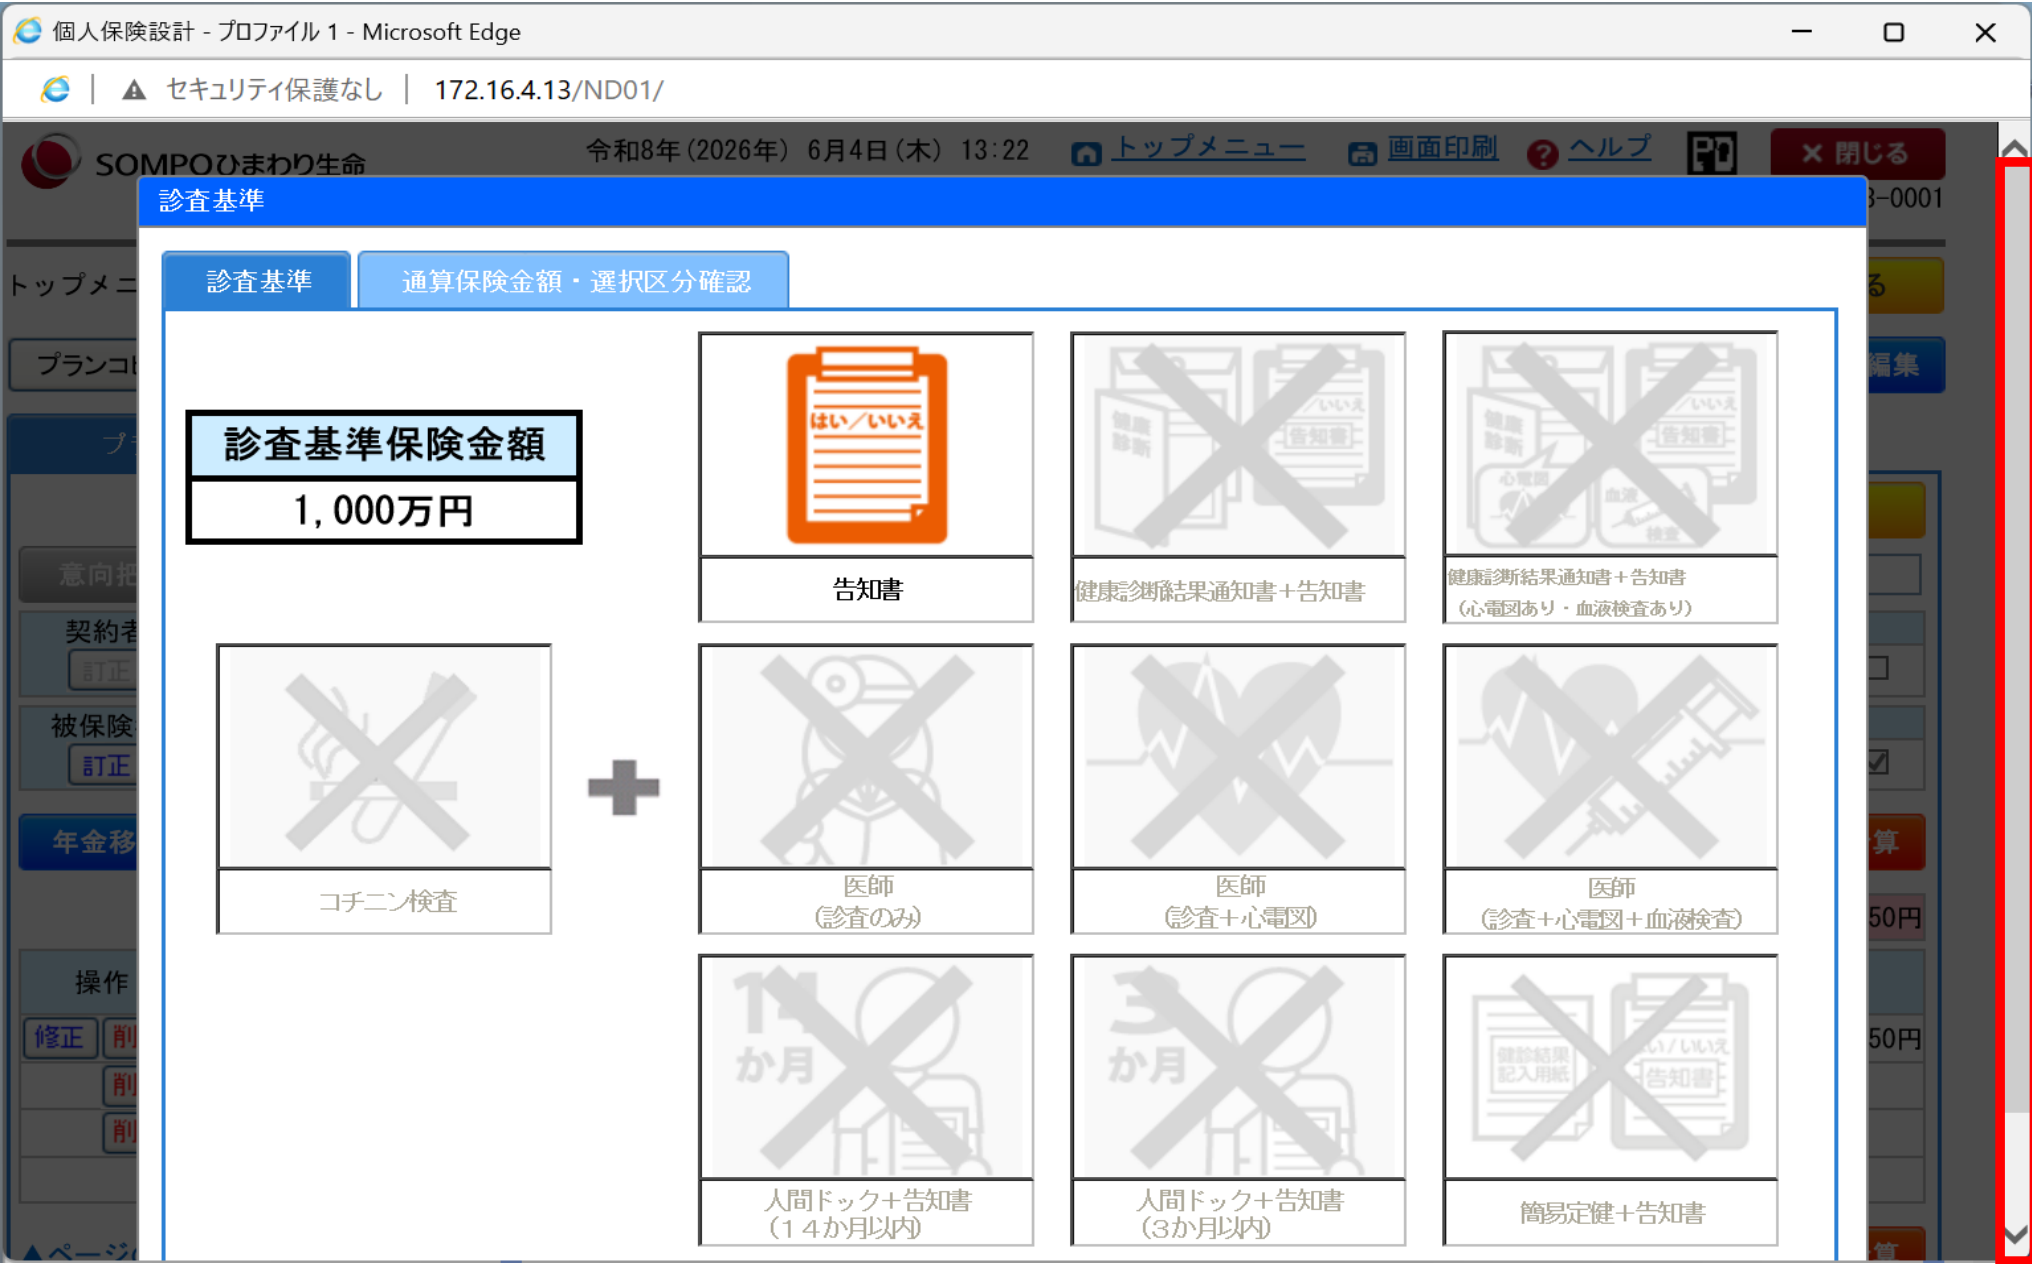

「閉じる」ボタンが表示される。

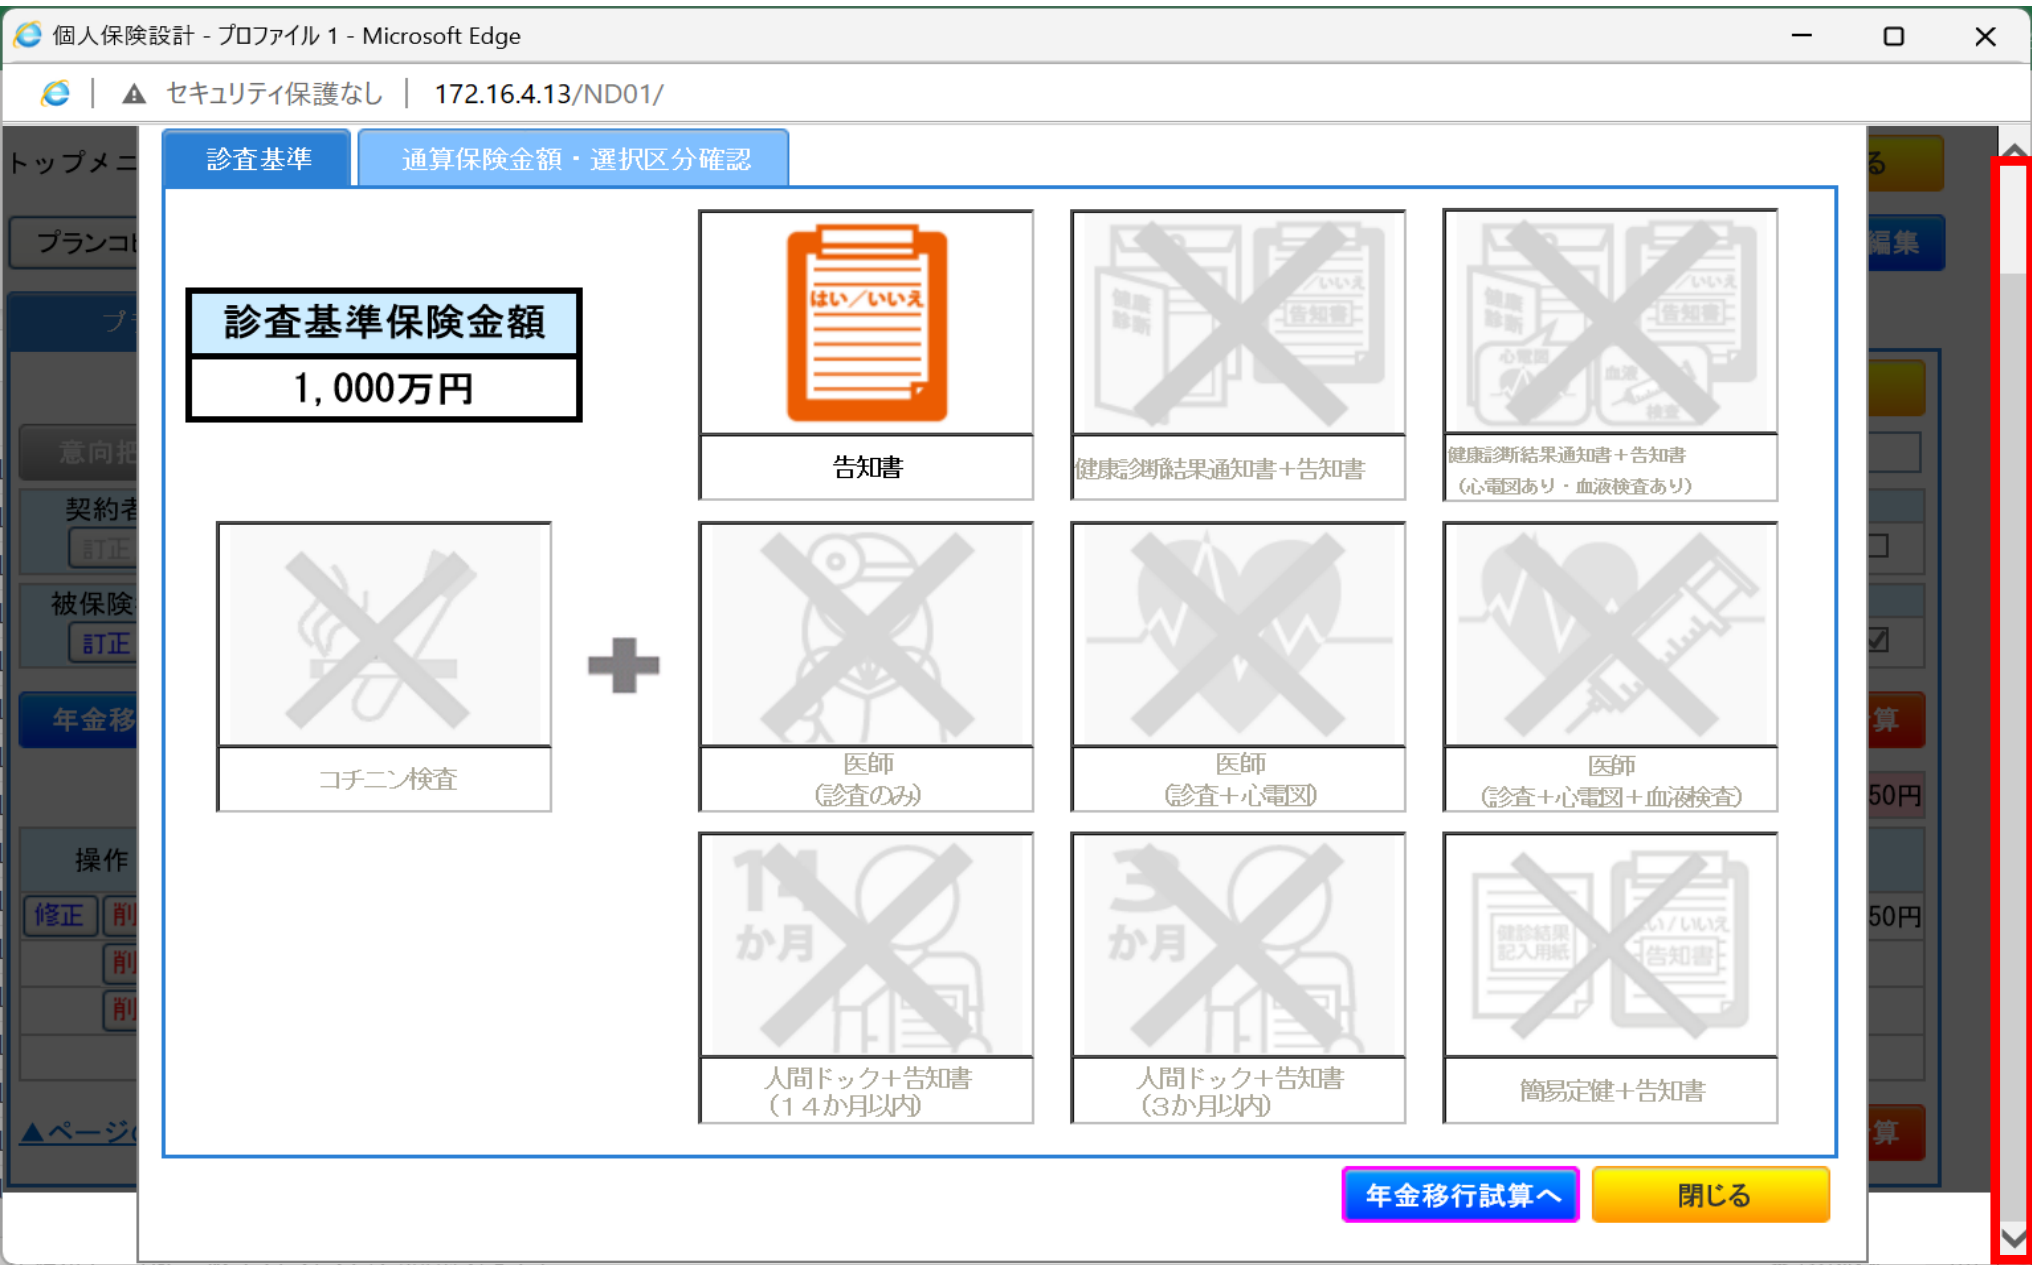

「拡大/縮小」を現状より小さくする。(150%→100%に変更)

明るさと色

 **明るさ**
内蔵ディスプレイの明るさを変更する

 **夜間モード**
青色の光をブロックするために、暖色を使用する

 **カラー プロファイル**
画面に表示される色を決定する

 **HDR**
[HDR に関する詳細情報](#)

拡大/縮小

テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更します

一部のアプリは、閉じてもう一度開くまで、拡大縮小の変更に応答しません。

100%

ディスプレイの解像度

接続されているディスプレイに合うように解像度を調整する

1920 × 1080 (推奨)

個人保険設計 - プロファイル 1 - Microsoft Edge

▲ セキュリティ保護なし | 172.16.4.13/ND01/

SOMPOひまわり生命

令和8年(2026年) 6月4日(木) 13:08

トップメニュー

画面印刷

ヘルプ

PD

× 閉じる

CTD: CND/01-0000 04410-0001

診断基準

診断基準

通算保険金額・選択区分確認

診断基準保険金額

1,000万円



告知書



健康診断結果通知書 + 告知書



健康診断結果通知書 + 告知書
(心電図あり・血液検査あり)



コチニン検査



医師
(診査のみ)



医師
(診査 + 心電図)



医師
(診査 + 心電図 + 血液検査)



人間ドック + 告知書
(14か月以内)



人間ドック + 告知書
(3か月以内)




簡易定健 + 告知書

年金移行試算へ


閉じる

解決策 2

「解決策 1」 拡大縮小とレイアウトが150%のままとした場合

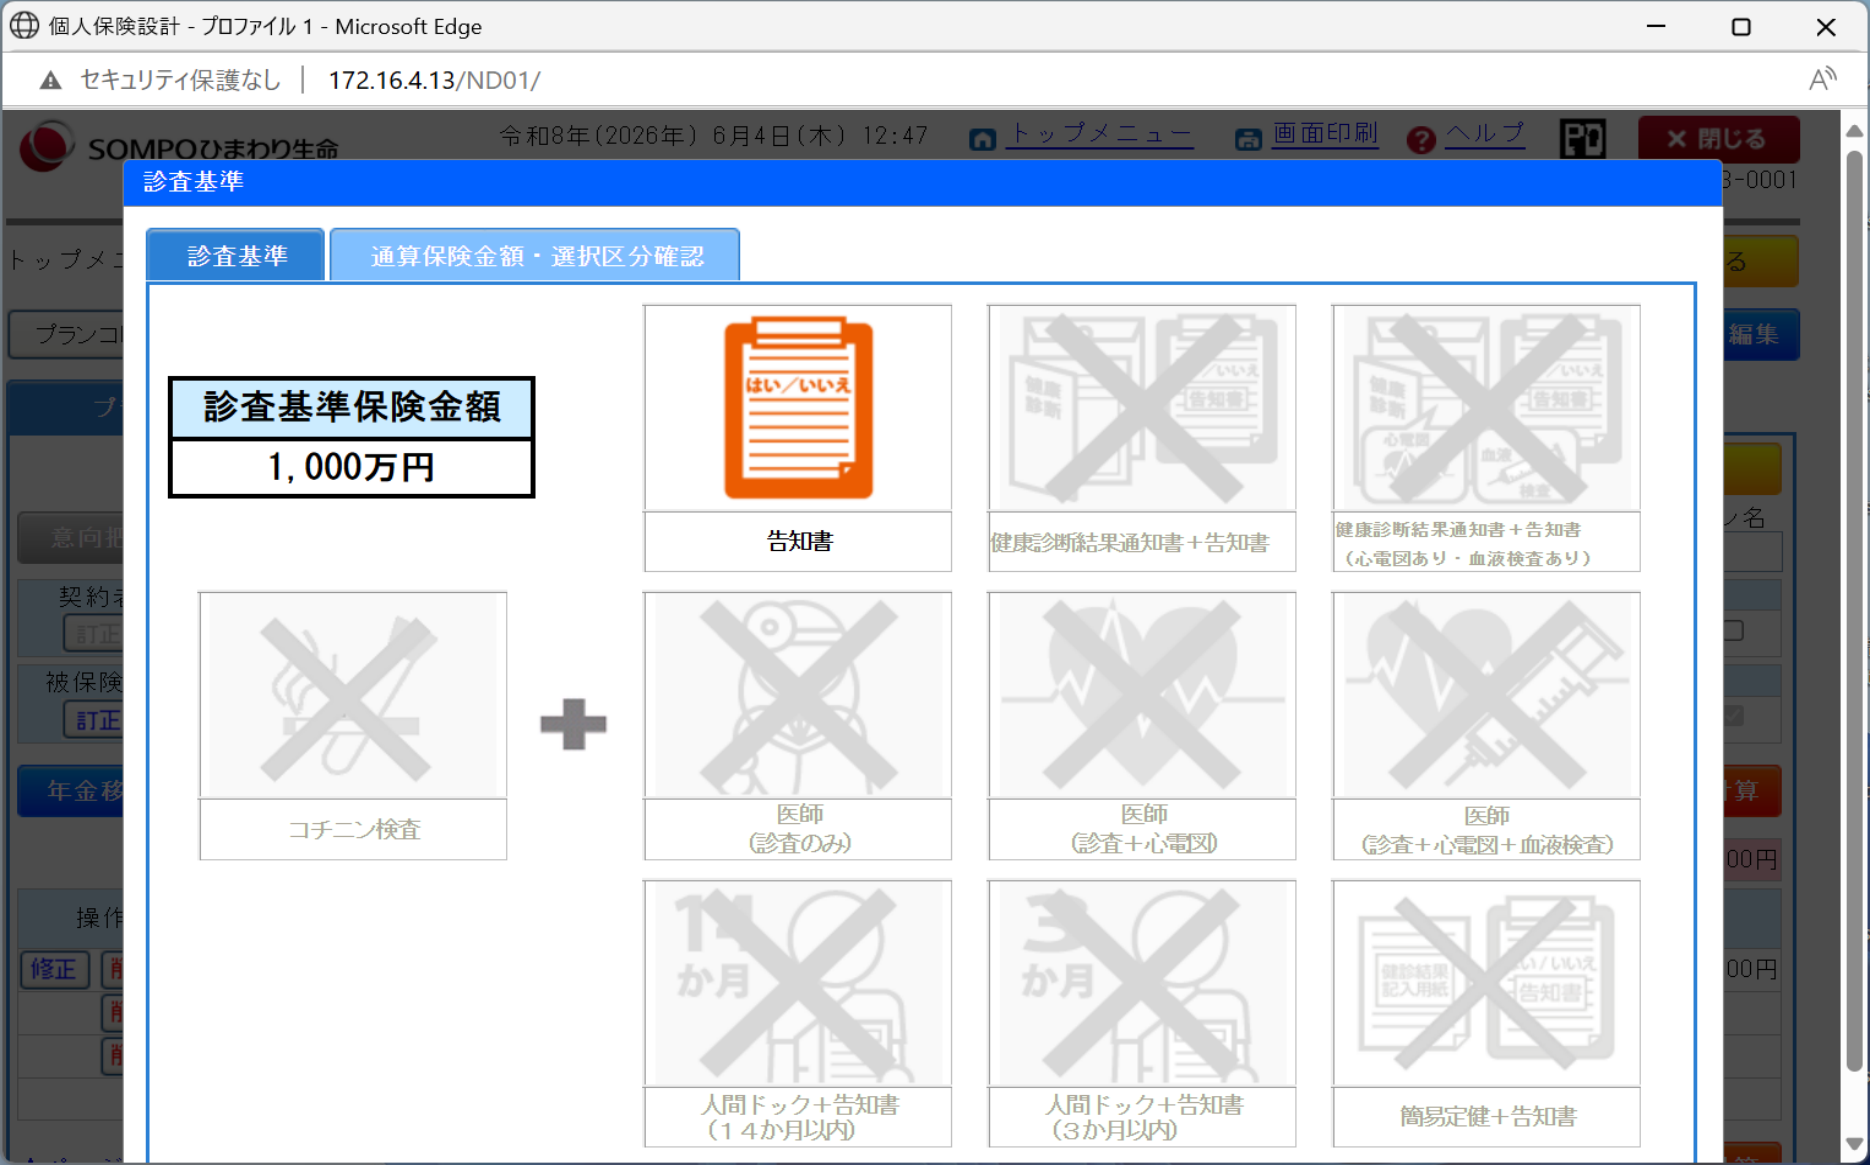

キーボードの「ctrl」ボタンを押下しながら、「-」（マイナス）ボタンを押下すると、表示されている画面を小さくできる。
「閉じる」ボタンが見えたら、「閉じる」ボタンで閉じる。

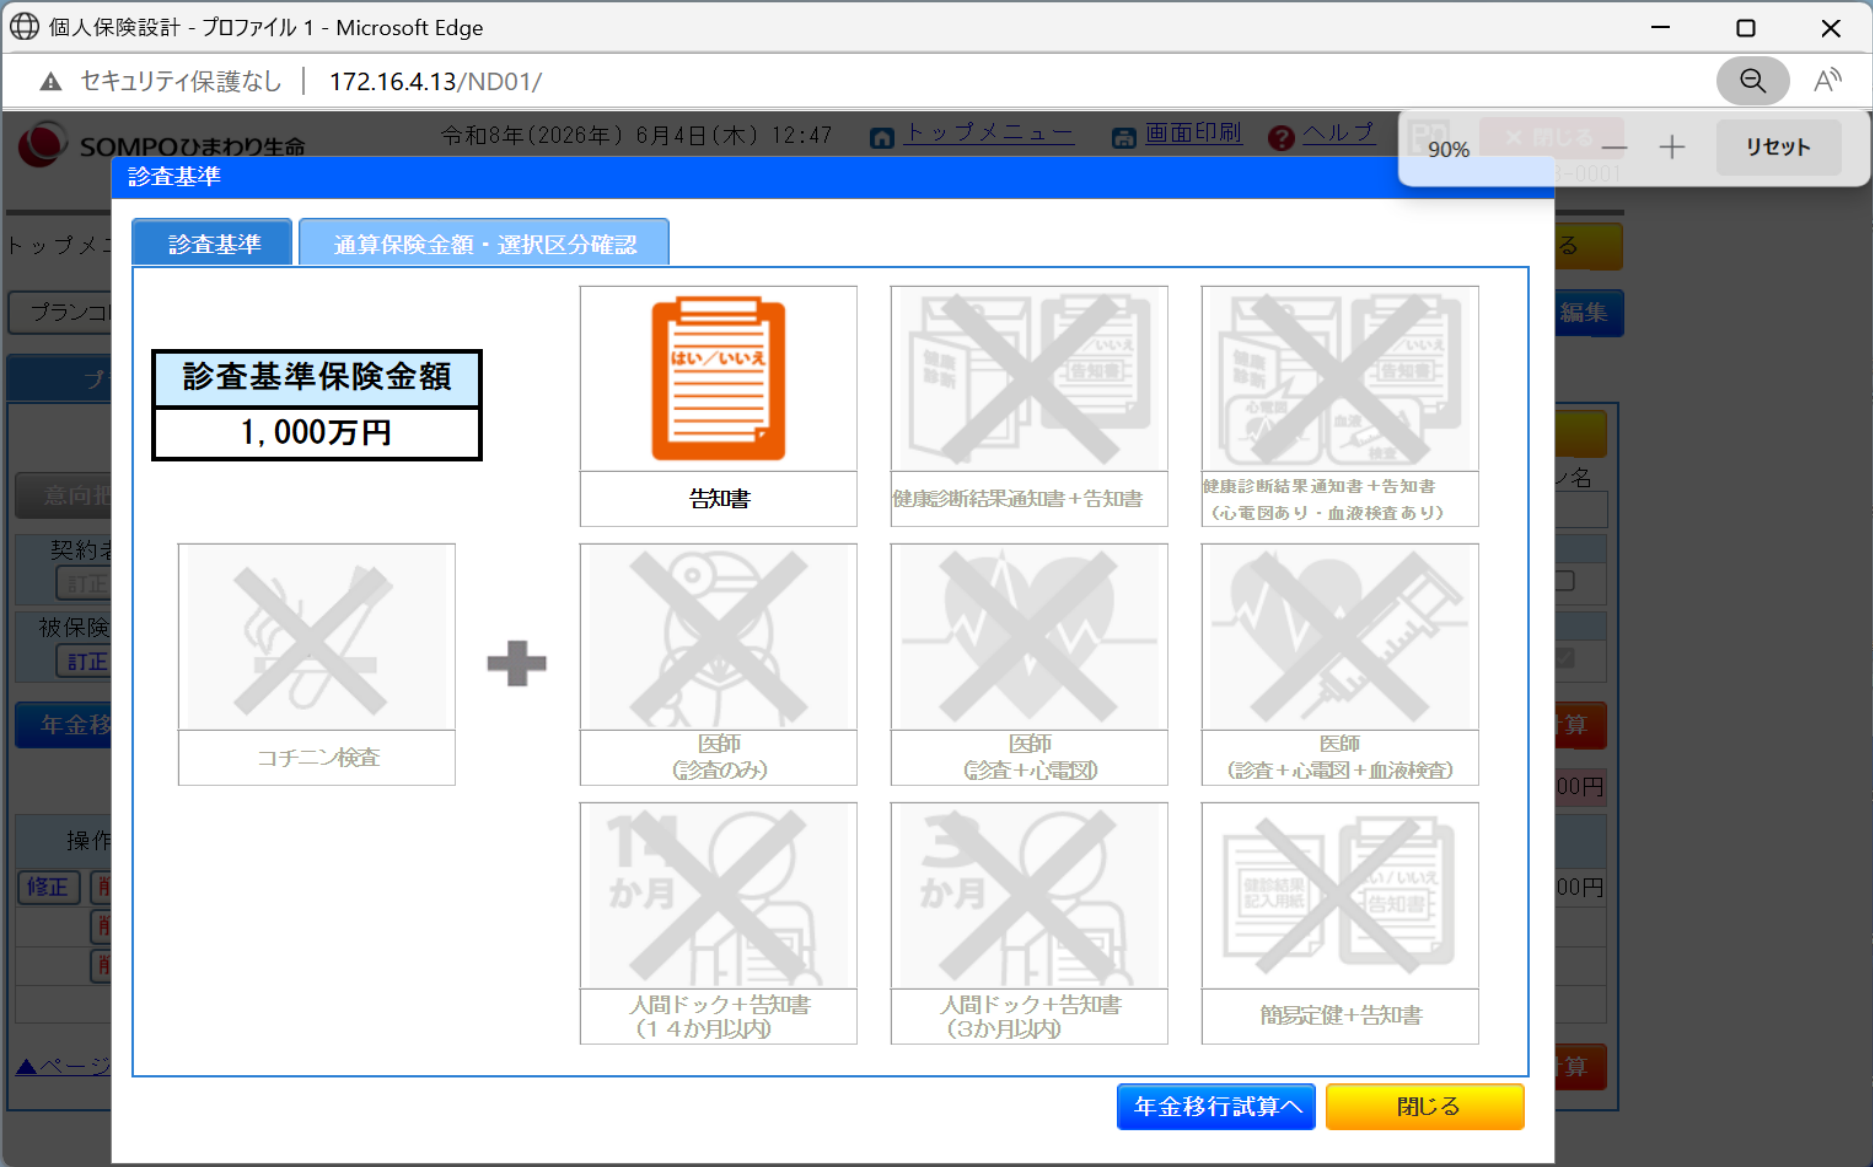

以上